



STUDIO PERITALE C.T.U. DANIELE GULLA'
INDAGINI FOTOGRAFICHE, ANTROPOLOGICHE, FONICHE, BIOMETRICHE E
MULTISPETTRALI, ELETTROMAGNETICHE
40127 BOLOGNA – VIA FANI, 7 – TEL. 339-3131594 – EMAIL: gulladaniele@libero.it


Bologna;14-05-2016

CONSULENZA TECNICA ANALITICA SULLA DIFFERENZA DI POTENZIALE
ENERGETICO MISURATO CON L'INTRODUZIONE DI ALCUNI DEI PRODOTTI
GEOLAM ANTIELETTROSMOG.

Qui sotto sono riportati i grafici dei test di spettro cromatografia con i Biomagneti al silicio L.A.M. ® posizionati a distanza.

Anche tenendo a notevole distanza dalla zona di rilevamento i vari dispositivi, dopo circa 5 minuti si possono misurare gli effetti positivi sull'ossigenazione. Dall'alto verso il basso:foto con dispositivi a circa 3 metri (PURITY e COMBIPLUS),al centro con dispositivi a circa 4 metri(GEOS e TRAVEL) e con dispositivo a 1,5 metri(FOCUS).

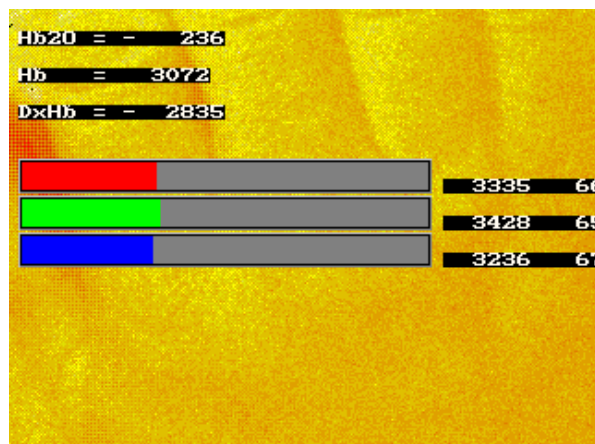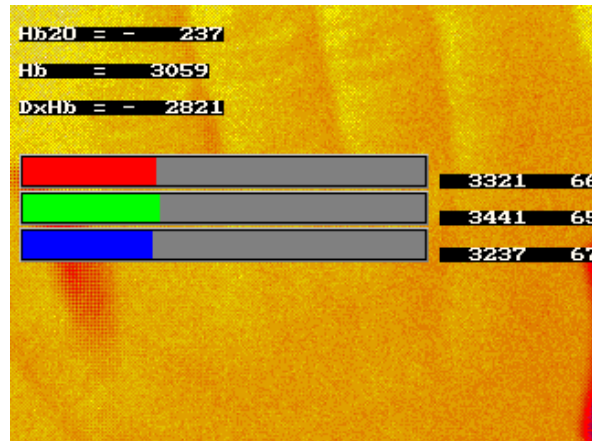

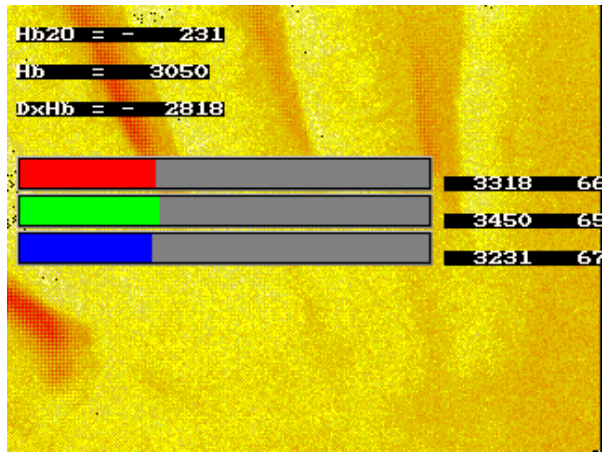

I dispositivi producono un effetto positivo sull'ossigenazione del sangue anche se posizionati al limite del loro raggio d'azione.

**Il tecnico esaminatore
DANIELE GULLA'**

Daniele Gulla'

.....

.....